

包装変更のご案内

機械器具74 医薬品注入器
管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器

グロウジェクター®L / グロウジェクター®DUO

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、医薬品・ワクチン用注入器「グロウジェクター®L」ならびに、「グロウジェクター®DUO」につきまして、包装変更致しますので、謹んでご案内申し上げます。
変更品出荷時には、新旧両製品が流通しご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、今後とも、より一層弊社製品のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 変更品目：グロウジェクター®L / グロウジェクター®DUO 一式
2. 変更内容：
 - (1) 製造販売元の住所変更に伴い、個装箱、本体定格ラベル、取扱説明書等の表示を以下の通り変更致します、また、併せて品番等も変更致します。
東京都港区西新橋2-38-5 ⇒ 東京都港区西新橋3-7-1
 - (2) グロウジェクター®L 取扱説明書につきましては、お客様相談窓口対応時間を追記致します。
3. 包装仕様変更内容
【グロウジェクター®L 個装箱裏面変更例】

【変更前】

Growjector®L

グロウジェクターLは、JCRファーマ株式会社製ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト 皮下注 6mg」「グロウジェクト 皮下注 12mg」専用の医薬品・ワクチン用注入器です。

- グロウジェクターLは、医師の指導のもとでお使いください。
- 取扱い方法及び保管方法は、パッケージの中の取扱説明書をご参照ください。
- 製品の落下に注意してください。製品が破損することがあります。

耐用期間：使用開始から3年間

輸送/保管時の環境条件 (梱包状態)
温度：0℃～50℃
湿度：10%RH～80%RH (但し結露しないこと)
こちらの蓋を下にして保管してください。

内 容 物	
グロウジェクターL	1台
専用充電台	1台
専用 AC/DC アダプター	1個
冷蔵保存ケース	1個
取扱説明書	1冊

販売元
JCRファーマ 株式会社
兵庫県芦屋市春日町 3-19

製造販売元
PHC株式会社
東京都港区西新橋 2-38-5



【変更後】

Growjector®L

グロウジェクターLは、JCRファーマ株式会社製ヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト 皮下注 6mg」「グロウジェクト 皮下注 12mg」専用の医薬品・ワクチン用注入器です。

- グロウジェクターLは、医師の指導のもとでお使いください。
- 取扱い方法及び保管方法は、パッケージの中の取扱説明書をご参照ください。
- 製品の落下に注意してください。製品が破損することがあります。

耐用期間：使用開始から3年間

輸送/保管時の環境条件 (梱包状態)
温度：0℃～50℃
湿度：10%RH～80%RH (但し結露しないこと)
こちらの蓋を下にして保管してください。

内 容 物	
グロウジェクターL	1台
専用充電台	1台
専用 AC/DC アダプター	1個
冷蔵保存ケース	1個
取扱説明書	1冊


販売元
JCRファーマ 株式会社
兵庫県芦屋市春日町 3-19

製造販売元
PHC株式会社
東京都港区西新橋 3-7-1

販売元
JCRファーマ 株式会社

製造販売元
PHC株式会社

【グロウジェクター[®]L取扱説明書最終頁変更例】

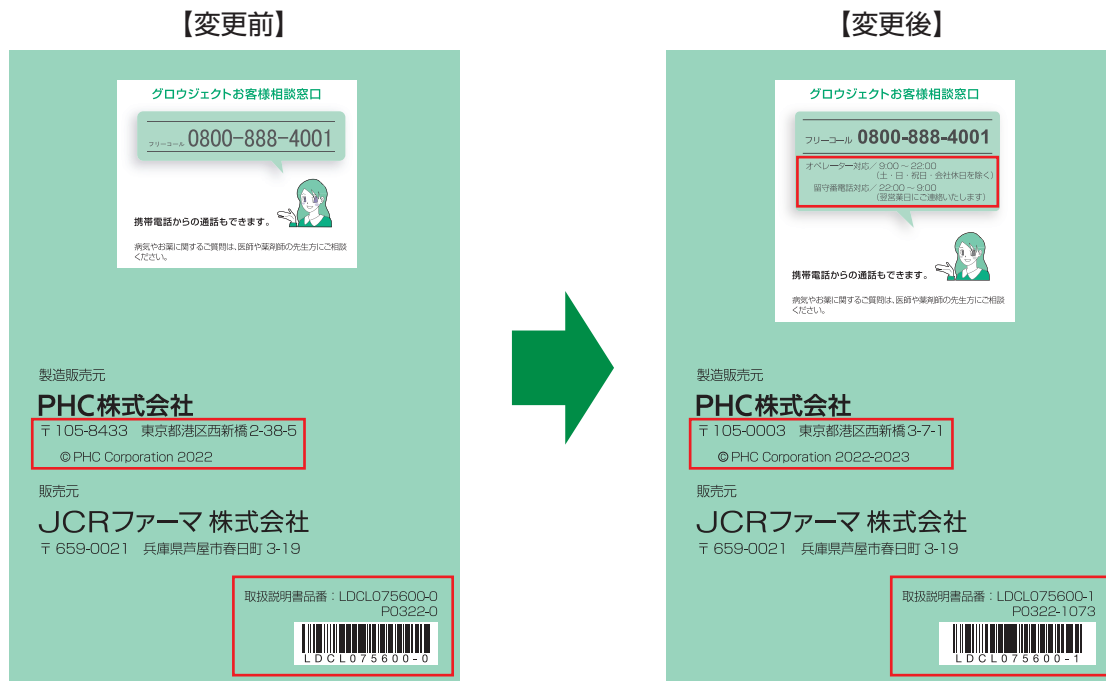

4. 変更品出荷予定時期ならびに初回製造番号

品名	包装	出荷予定時期	初回製造番号
グロウジェクター [®] L	1台	2024年9月上旬頃	273K1171
グロウジェクター [®] Duo	1台	2025年11月上旬頃	293L0109

※変更品の出荷時期は、弊社から特約店へのお荷予定を表示しております。また、弊社在庫状況により、出荷予定時期が異なることもございますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

以上